دستورالعمل پمپ تشک مواج مارک RAEEN مدل AP1000

۱. ابتدا کابل برق و دو شلنگ تشک را به پمپ وصل نمایید.

۲. دکمه پـــــاور را در وضعیت on قـــرار دهید.

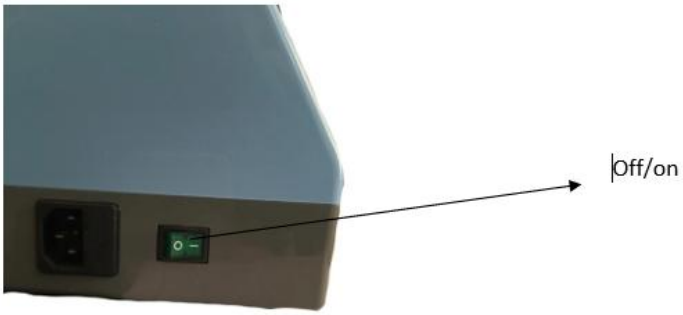

۳. جهت انجام تنظیمات دکمه set را فـشار دهید.

۴. ابتـدا پـارامتر وزن بیمـار (weight) روی LCD شـروع بـه چشـمک زدن مـی کنـد و بـه وسـیله دو دکمه تنظیمی up و Down (و) وزن بیـــمار تـوسط اپراتور تـنظیم می شود.

۵. مجددا دکمه **Set** را فشار دهید **(یعنی باید دوبار فشار دهیم)**، تا زمان تناوب (time) بر روی **LCD** شروع به چشمک زدن کند. اکنون اپراتور می تواند به وسیله دو دکمه تنظیمی **up** و **Down** (و) این زمان را بر روی ۱۰ ، ۱۵ و ۲۰ دقیقه تنظیم کند.

۶. پس از انجام تنظیمات دکمه **Set** مجددا زده می شود و دستگاه از منوی تنظیمی خارج می شود و مطابق تنظیمات انجام شده عمل می کند. البته بعد از چند ثانیه دستگاه اتوماتیک میز وارد مد عملکردی بر اساس تنظیمات خواهد شد.

۷. برای تنظیم **mode** دستگاه باید از وضعیت **setting** خارج شده باشد. در اینصورت با استفاده از کلید **mode**( ) ،مد دستگاه را تغییر می دهیم یعنی حالت استاتیک یا داینامیک بنابر شرایط بیمار.

لازم به ذکر است که دستگاه طور برنامه ریزی شده است که ابتدا بر روی مد Static قرار می گیرد و تا زمان پر شدن کامل تشک در همین وضعیت قرار دارد و بعد از آن مطابق برنامه، مد آن تغییر کرده و در حالت تناوبی (Dynamic) کار خود را ادامه می دهد. در صورتی که تشک نشتی نداشته باشد این تغییر مد زمانی انجام می شود که فشار داخل سلول ها به فشار تنظیمی دستگاه برسد، در غیر اینصورت دستگاه پس از ۴۵ دقیقه تغییر مد می دهد و آلارم آن فعال می شود و در صورت وجود هرگونه نشتی در مدار هوایی A,B دستگاه شروع به آلارم زدن (دیداری و شنیداری) می کند و در این حالت اپراتور میتواند آلارم شنیداری را بوسیله کلید تعبیه شده روی پنل قطع نماید اما آلارم دیداری همچنان فعال خواهد بود.

۸. برای تنظیم آلارم دستگاه باید از وضعیت setting خارج شده باشد. در اینصورت با استفاده از کلید () آلارم صوتی را خاموش می کنیم. توجه داشته باشید با خاموش کردن آلارم فقط آلارم صوتی خاموش می شود و (LED) آلارم نوری(دیداری) در حالت روشن قرار خواهد داشت.

۱. توجه: جهت تخلیه تشک می بایست از دریچه CPR استفاده شود زیرا کانکتورهای دستگاه مذکور TTC می باشند و پس از جدا شدن از پمپ کاملاً بسته شده و مانع تخلیه تشک می گردند.

تذکر: پس از انجام تنظیمات و در حین کار، عملکرد دکمه Down تبدیل به Alarm on و یا Alarm off و دکمه up تبدیل به حالتهای Dynamic و Static می شود.

نگهداری از دستگاه:

تمیز کردن پمپ بوسیله یک دستمال نم دار الکلی انجام می گردد و جهت تمیز کردن تشک نیز می توان از محلول های ضدعفونی مجاز بیمارستانی نظیر سایدکس استفاده نمود. لازم به ذکر است که تشک قابلیت شستشو با وسایل اتوماتیک رختشوئی را ندارد.